

浜松医科大学医学部附属病院
外来棟地下1階滅菌室廃水滅菌処理装置部品交換業務

仕 様 書

令和8年7月

課 長	課長補佐	保全係長	担 当
			

I. 業務概要

1. 業務名 浜松医科大学医学部附属病院外来棟地下1階滅菌室廃水滅菌処理装置部品交換業務
2. 業務場所 浜松市中央区半田山一丁目20番1号 浜松医科大学構内
3. 業務期限 令和 9年3月26日(金)
4. 業務仕様
 - (1) 本仕様書に記載されていない事項は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則、文教施設保全業務標準仕様書(令和5年版)(以下「標準仕様書」という。)に基づき、業務を履行する。
 - (2) 本仕様書、標準仕様書に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。

5. 実施業務

業務場所	用途区分	対象設備	実施業務
外来棟	附属病院	廃水滅菌処理装置 自動制御盤	シーケンサー部品交換 交換対象機器は別図1による

※作業は本学の運営に支障がないよう十分協議のうえ実施すること

II. 一般共通事項


1. 請負代金の支払い

この業務の受注者は、発注者の指定した者が業務報告書等により業務の履行を確認したときは、請負代金の支払いを請求できる。
請負代金の支払いは、業務完了後、浜松医科大学会計課から1回に支払う。
2. 業務現場管理
 - (1) 業務条件
 - ①作業日は、病院の運営に支障がないよう施設管理担当者と十分協議するものとする。
なお、施設管理担当者は保全係長とする。
 - ②作業関係車両の敷地内入場・駐車許可及び作業時に必要な照明・水道・電源・は無償とする。
3. 施設管理担当者の立会い


次の場合は、施設管理担当者の立会いを受ける。

 - 1) 施設管理担当者が特に指示した場合
 - 2) 受注者の申し出により、施設管理担当者が必要と認めた場合
4. 業務の報告
 - 1) 業務完了後に以下の書類を1部提出する。
 - ①試験結果報告書
 - ②業務写真
5. その他
 - (1) 契約図書及び関係図書を、業務の履行のために使用する以外の目的で第三者に使用させてはならない。また、その内容を漏洩しない。ただし、施設管理担当者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
 - (2) 受注者は、設備の専門知識を有する者を業務責任者として配置する。
 - (3) 本業務仕様書に定めのない事項については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条の基本方針(20-6庁舎管理等)に定める【判断基準】及び【配慮事項】を適用する。


別図 1

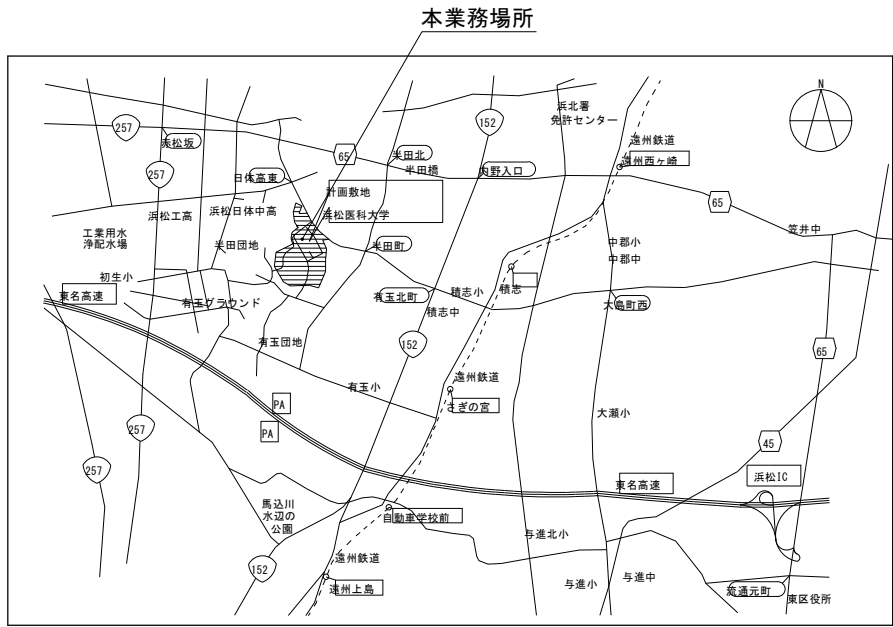

案内図 (No Scale)

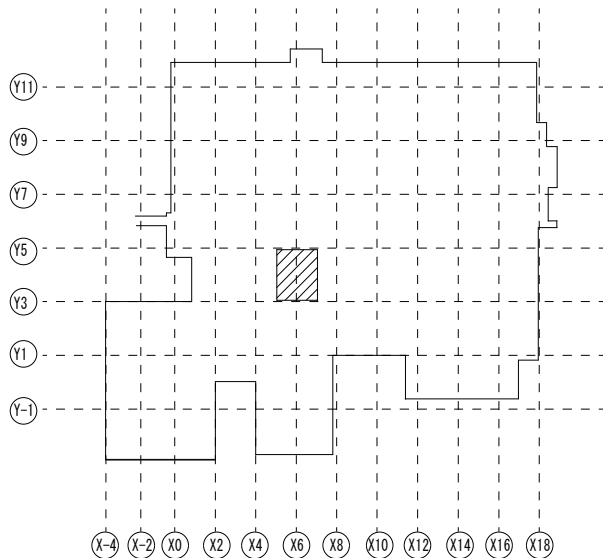

Key Plan

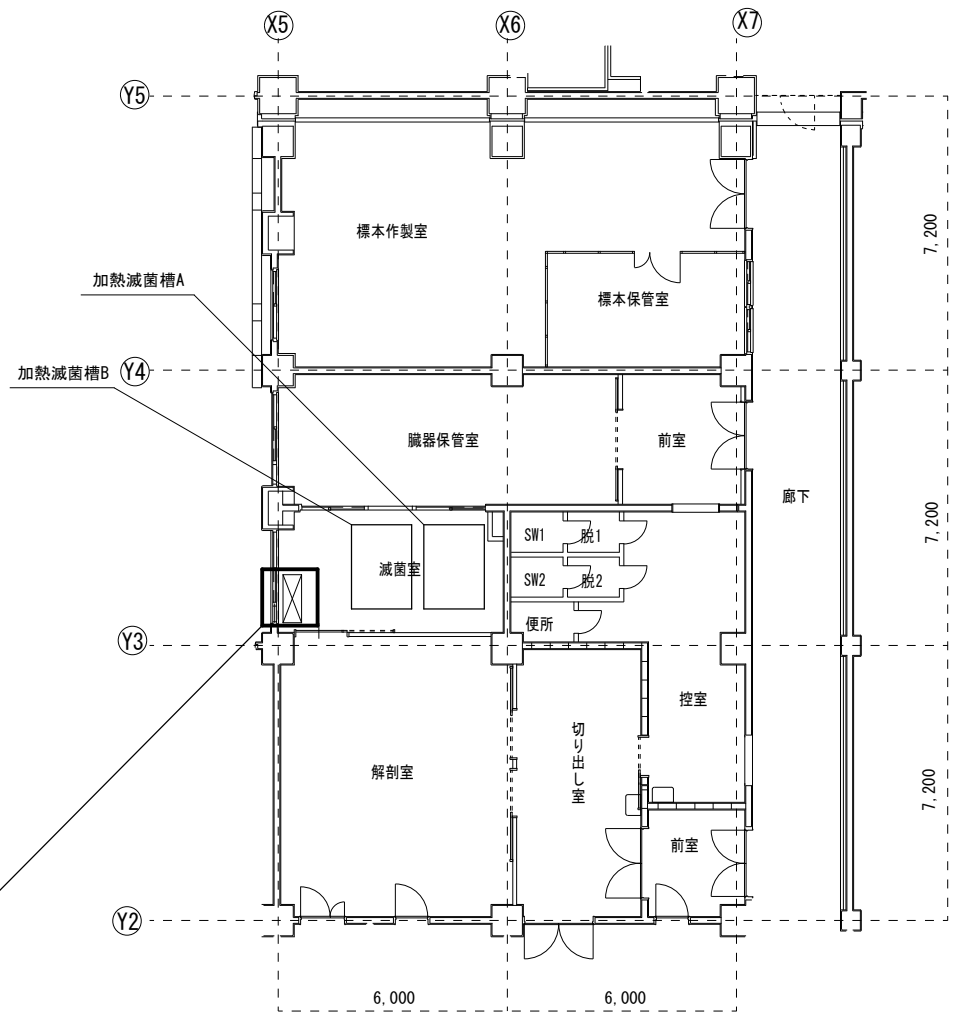

外来棟地下1階 設置詳細図 1/200

廃水滅菌処理装置
自動制御盤

業務内容

廃水滅菌処理装置自動制御盤の既設シーケンスを撤去の上、
相当品に交換する。※プログラム作成・検査関連作業を含む

【交換部品（既存）：型番】

基本ユニット：オムロン株式会社 CQM1H-CPU11×1台

電源ユニット：オムロン株式会社 CQM1-PA206×1台

入力ユニット：オムロン株式会社 CQM1-ID212×3台

出力ユニット：オムロン株式会社 CQM1-OC222×3台

出力ユニット：オムロン株式会社 CQM1-OD213×2台

アナログ入力ユニット：オムロン株式会社 CQM1-AD041×1台


給電ユニット：オムロン株式会社 CQM1-IPS01×1台

※業務により発生した撤去品は請負者の責任の下に構外搬出処分する。

廃水滅菌処理装置 仕様

メーカー	株式会社エンバイス
型式	SRS-500W
処理対象	要滅菌排水
処理能力	0.5 m3/回
処理方法	高圧蒸気による加熱滅菌法
運転方法	滅菌槽排水直接受入方式による2槽交互運転
処理時間	約3時間
電源	AC200V-3C

※上記仕様を満たした運転をするものとする

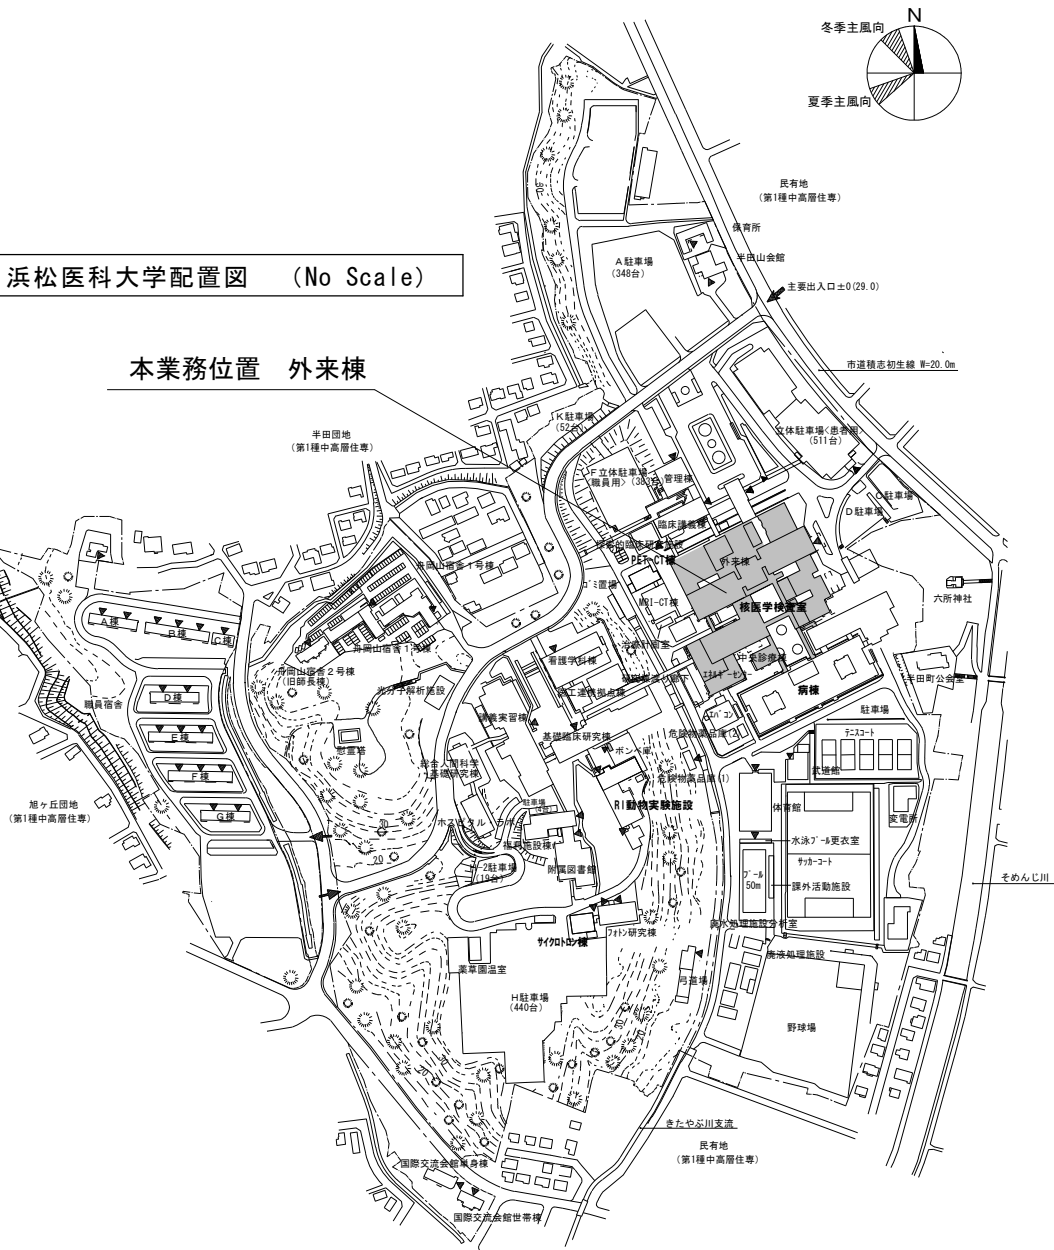

浜松医科大学配置図 (No Scale)

本業務位置 外来棟